



Algorithme clinique pour la sélection de l'équipement au bain

N° de dossier du client

Nom du client

Visité par

Date

SECTION 1

SECTION 1

Discuter avec un ergothérapeute au besoin

La clientèle

Le client

- est atteint d'une maladie neurologique dégénérative (ex. Parkinson ou sclérose en plaques) OU
- est en fin de vie OU
- a une contre-indication médicale, quelle qu'elle soit.

Vérifié par

Date

NON OUI

OCCUPATION

La personne

- se déplace seule jusqu'à la baignoire OU la cabine de douche ET
- accepte de ne pas aller au fond de la baignoire pour se laver.

OUI NON

PERSONNE

La personne

- est âgée de 18 ans ou plus ET
- pèse moins de 250 livres ET
- a la capacité de se lever et se tenir debout durant 5 secondes ET
- peut prendre appui sur une barre ET
- comprend les consignes.

OUI NON

ENVIRONNEMENT

La salle de bain utilisée

- comprend une cabine de douche OU une baignoire standards ET
- permet d'installer deux barres d'appui.

OUI NON

Arrêt

Voir Section 2

Le choix du siège

OCCUPATION

La personne peut se transférer d'une chaise à une autre.

NON OUI

Souhaite se doucher dans sa cabine de douche.

NON OUI

Souhaite se doucher dans sa baignoire.

NON OUI

 Arrêt

Peut écarter les pieds d'environ 12"
ET
 Peut lever les pieds à la hauteur du seuil de sa cabine de douche.

NON OUI

Peut écarter les pieds d'environ 12"
ET
 Peut lever les pieds à la hauteur du rebord extérieur de sa baignoire.

OUI

NON

PERSONNE

En position assise et les yeux fermés, bouge le tronc sans perdre l'équilibre
ET
 N'est pas fatiguée, étourdie ou essoufflée durant la tâche.

NON OUI

Atteint ses jambes et ses pieds en position debout
ET
 N'est pas fatiguée, étourdie ou essoufflée durant la visite.

OUI

NON

En position assise et les yeux fermés, bouge le tronc sans perdre l'équilibre
ET
 En position assise, peut lever les pieds à la hauteur du rebord extérieur de sa baignoire
ET
 N'est pas fatiguée, étourdie ou essoufflée durant la tâche.

NON OUI

Peut se relever de la hauteur du rebord extérieur de sa baignoire + 1".

OUI

NON

ENVIRONNEMENT

La largeur du fond de sa baignoire ou de sa cabine de douche mesure 18" ou plus
ET
 Possibilité d'installer un tabouret.

OUI

NON

La largeur du fond de sa baignoire ou de sa cabine de douche mesure 18" ou plus
ET
 Possibilité d'installer un siège de douche stationnaire avec dossier.

OUI

NON

La largeur du rebord intérieur de sa baignoire mesure 3/4" ou plus
ET
 Possibilité d'installer une planche de transfert.

OUI

NON

La hauteur du rebord extérieur de sa baignoire est de 19" ou moins
ET
 Possibilité d'installer un fauteuil de transfert.

OUI

NON

RECOMMANDATIONS


 Aucun siège Tabouret de bain / douche Arrêt Siège de douche stationnaire avec dossier Arrêt Planche de transfert au bain Fauteuil de transfert au bain Arrêt

Algorithme clinique pour la sélection de l'équipement au bain

Discuter avec un ergothérapeute au besoin

Voir Section 3 (document distinct)

SECTION 4 Notes

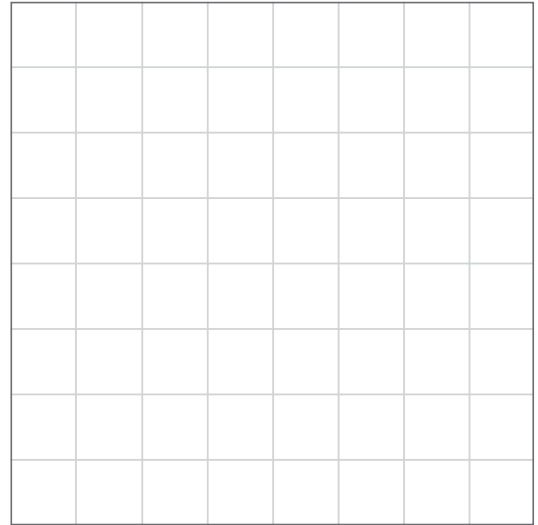


Pour ajouter un dessin, utilisez l'outil « Dessin » d'Adobe Reader ou de votre application.



Baignoire

- Situation actuelle
- Situation proposée

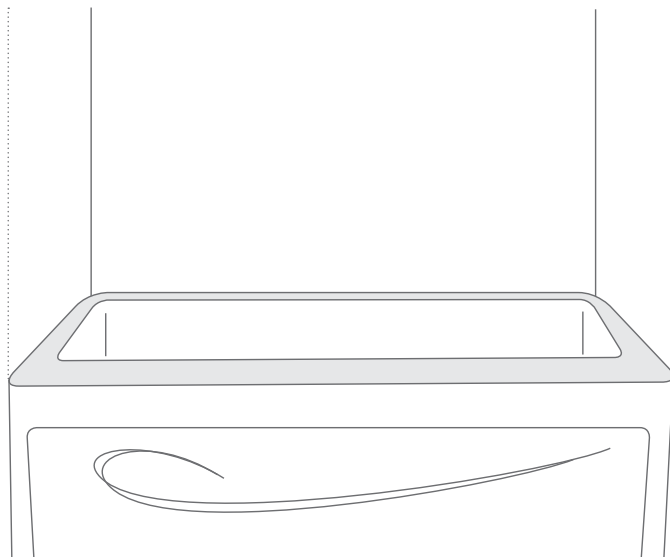

Cabine de douche

- Situation actuelle
- Situation proposée

